

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De acuerdo a los elementos solicitados para realizar Ensayos por agentes de la Sección Tecnología y Control, deberán reunir las siguientes condiciones:

1. PROBETA GRADUADA CILINDRICA SIN PICO:

La probeta debe ser cilíndrica; sin pico; material plástico transparente. Diámetro interior: 31,7 mm.; Altura aproximada: 430 mm.; Graduada a partir de la base en divisiones cada 2 mm., llegando a los 380 mm. de longitud. La Graduación llevará una línea más larga cada cinco (5) divisiones y se numerará cada diez (10) divisiones comenzando desde la Base.

2. PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO:


Equipo compuesto por tres (3) partes: manija, martinete y lanza. Material: Acero galvanizado.

Martinete: Conformado por la masa (8 kg) de caída libre y una varilla que guía la caída desde una longitud de 575 mm.

Lanza de Penetración: diámetro: 16mm, con regla para la medición de la profundidad de hincamiento.

Dos zapatas cónica (puntas) de acero: tratado térmicamente, con ángulo de conicidad de 60°.

Extractor de lanza.

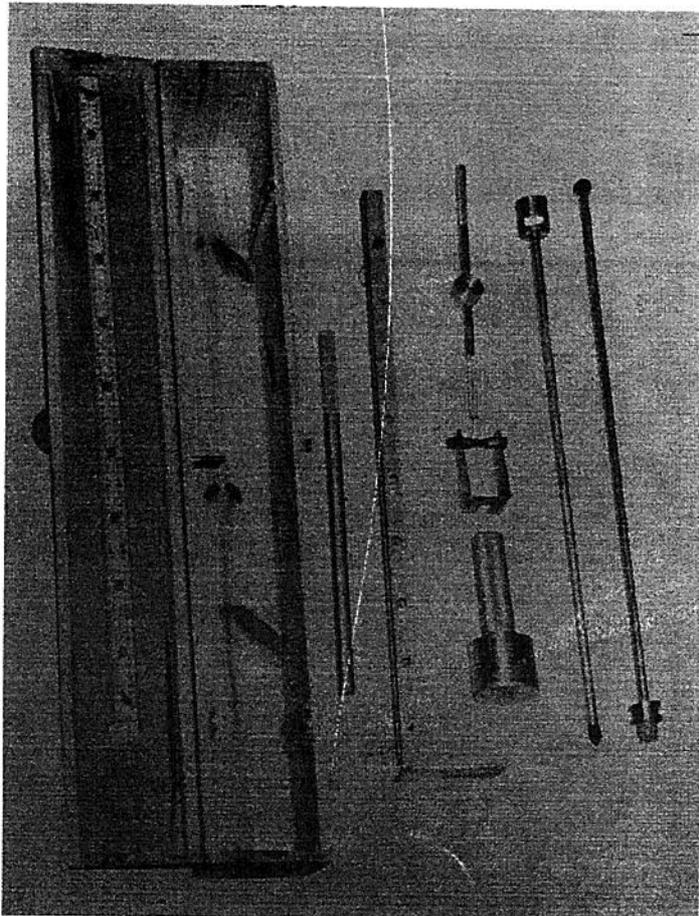


Fab. LUIS A. FRANZONI
D.N.V.